
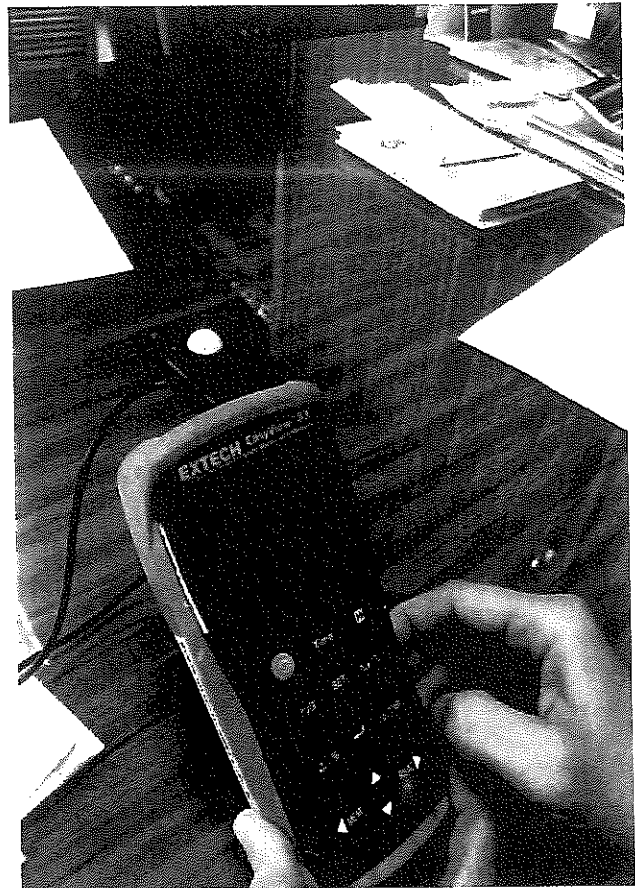


การปรับวัดแสงสว่างที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

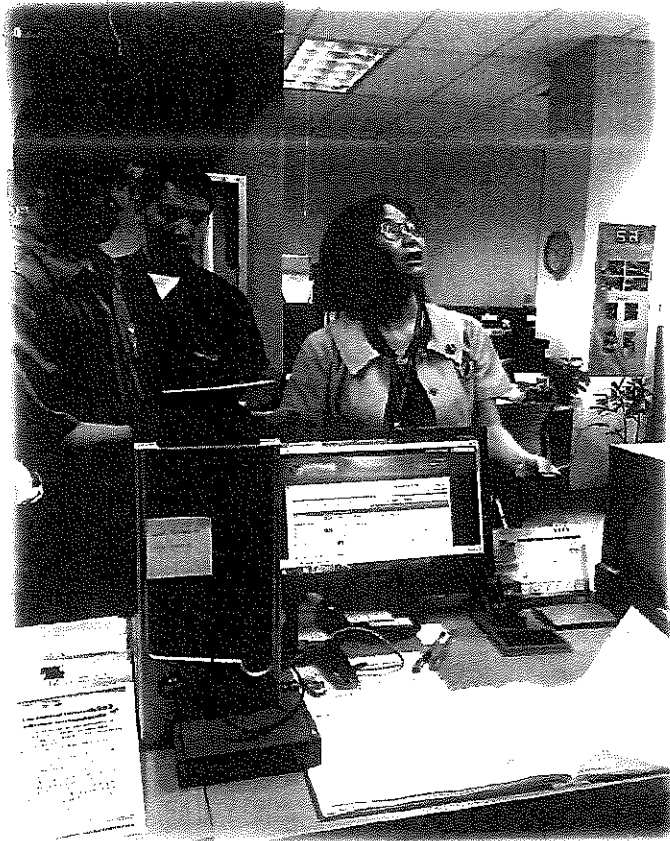

เครื่องวัดความเข้มของแสง ยี่ห้อ Extech รุ่น Easy View TM-33

หมายเลขครุภัณฑ์ 08119366 บ.1257

หน่วยงานเจ้าของ : กรมวิศวกรรมกรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน้า 6

